


Information 9-1.0.1 I

08.00/01.07

Luftdruckänderung von NN 0 m bis 4.000 m Höhenlage

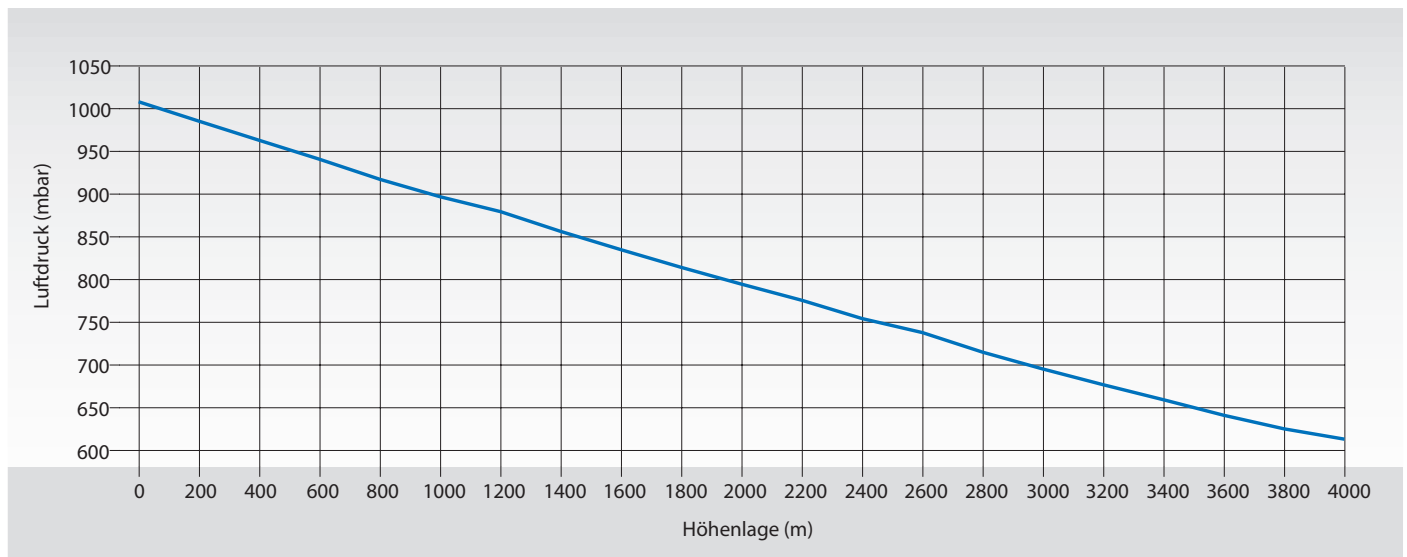

Empfindlichkeitseinstellbereich der O₂-Analytoren zur Anpassung der Einsatzort-Höhenlage prüfen, Luft mit Normaldruck 1013 mbar = 20,93 Vol.-% O₂.

Endwert-Einstellung in (Vol.-% O₂), Kalibrierung mit Luft bei 1013 mbar:

Voraussichtliche Höhenlage (m)	O ₂ - Einstellwert (Vol.-%)
0	20,93
500	22,20
1000	23,58
2000	26,67
4000	34,42